SPORTEC
Physio & Fitness

www.sport-tec.de

THERAPIELIEGE SMART ST4

ANLEITUNG

Art.-Nr. 23309 · Kategorie: Therapieliege Smart ST

Eigenschaften und technische Spezifikationen der Modelle:

Mod.

“MATISSE PRO ”

- 240011
- 240011P MATISSE Pro
- 240011R
- 240011PR

- 241011
- 241011P MATISSE PRO 2 + 2
- 241011R
- 241011PR

“SMART ST”

THIS DIESE ANLEITUNG SOLLTE MIT DEN ALLGEMEINEN SICHERHEITSHINWEISEN AUFBEWAHRT WERDEN

- **Typenschild**
- **Konformitätserklärung**
- **Bedienelemente**
- **Ersatzteile und Hilfe**

DIESE ANLEITUNG MUSS VOR INSTALLATION UND GEBRAUCH DURCHGELESEN WERDEN

Die Anleitung ist in Reichweite aufzubewahren und bei Bedarf hinzuzuziehen.

INHALTSVERZEICHNIS

I. WARENZEICHEN UND ETIKETT 3

II. KLASSIFIKATION UND NUTZUNG 4

III. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 5

IV. BEDIENELEMENTE UND EINSTELLUNGEN 6

V. VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ERSATZTEILE – KUNDENDIENST 9

PRODUKT INFORMATION 10

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE 11

I. WARENZEICHEN UND ETIKETT

Etikett - Erläuterung

An die Therapieliege wurde eine Kopie des unten abgebildeten Kennzeichnungsetiketts, zusammen mit den zugehörigen technischen Informationen, angebracht. Dieses dient dazu, das Produkt und seine Spezifikationen zu identifizieren, wenn technische Probleme auftreten oder Ersatzteile benötigt werden.
Das Etikett darf **NIEMALS** entfernt, beschädigt oder abgedeckt werden.

KENNZEICHNUNGSETIKET

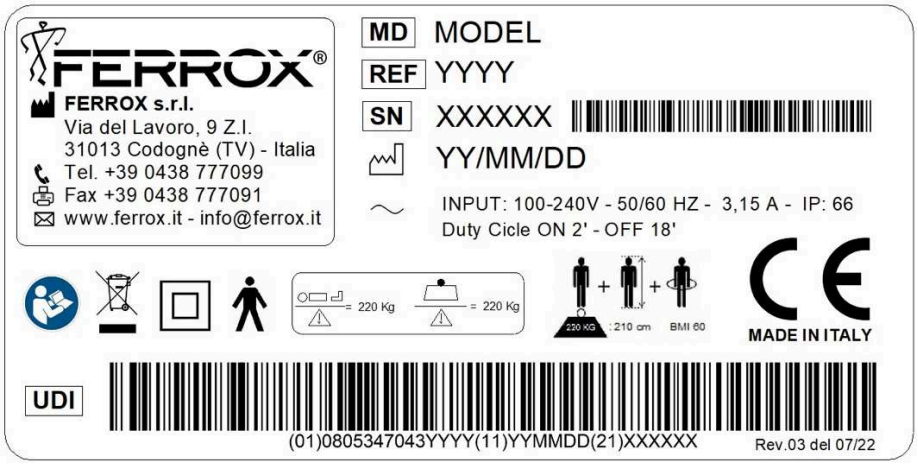

Symbol	*Beschreibung*		*Symbol*	*Beschreibung*
MD	Dies ist ein Medizinprodukt			Die WEEE Richtlinie zu Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall
REF	Katalognummer			Elektrische Isolierung: Klasse **II**
SN	Seriennummer			Anwendungsteil, Typ B (IEC)
	Name des Herstellers		= Kg = Kg	- Maximales Patientengewicht - Maximal erlaubtes Bettgewicht
	Herstellungsdatum		≥40 kg ≥146 cm BMI≥17	- Maximales Patientengewicht - Maximale Körpergröße - Body-Mass-Index
	Produkt wird mit Wechselspannung betrieben			- Achtung Quetschgefahr für Hände und sonstige Gliedmaßen
	Sichere Arbeitslast		CE	CE Kennzeichen MDR 2017/745
	Anleitung lesen		UDI	Einmalige Produktkennung

II.KLASSIFIKATION UND NUTZUNG

“MATISSE PRO II” Cod. 240011, 240011P, 240011R, 240011PR
Cod. 241011, 241011P, 241011R, 241011PR

- Anwendungsteil, Typ B (IEC)
- Elektrische Isolierung, Klasse **II**
- Schutzart: IPX6
- Sichere Arbeitslast: 160 kg
- Polster und Bezug Typ 1-IM

- **Ohne** Ersatz-Akku*(**1**)
- **Mit** Verriegelungsfunktion

Verwendung: Die Therapieliege eignet sich insbesondere für den Einsatz in den Bereichen der Rehabilitation und Physiotherapie, kann aber auch in anderen Bereichen verwendet werden. Die Liege ist gemäß den nachstehend aufgeführten EMV-Angaben zu installieren:

! Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen als den angegebenen Zwecken.

! Jeder schwere, durch das Gerät verursachte Unfall muss gemeldet werden. Die Meldung ist an den Hersteller sowie an die zuständige Behörde zu richten.

Es ist **kein** Ersatz-Akku* (1) eingebaut. Die Liege kann daher in sämtlichen Bereichen sicher eingesetzt werden, **außer** in Krankenhäusern und Umgebungen, in denen Notfallmaßnahmen einen kontinuierlichen Betrieb der Liege im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung erfordern können.

Die Liege kann in stark frequentierten Umgebungen, sogar in Anwesenheit von Kindern, sicher eingesetzt werden, da alle Versionen über eine Funktionsverriegelung **verfügen**.

Die Trendelenburg Funktion ist nicht in allen Ausführungsmodellen vorhanden.

Elektrischer Motor - Einschaltzeit: alle 18 Min., 2 Min. Pause

***(1)** Der Ersatz-Akku ist optional und kann durch den Hersteller – **ausschließlich das Originalprodukt des Herstellers** – installiert werden.

Ferrox Therapieliegen sind als Medizinprodukte der Klasse I klassifiziert, im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017 über Medizinprodukte.

III. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<u>Abmessungen</u> **cod : 240011** **cod : 241011**

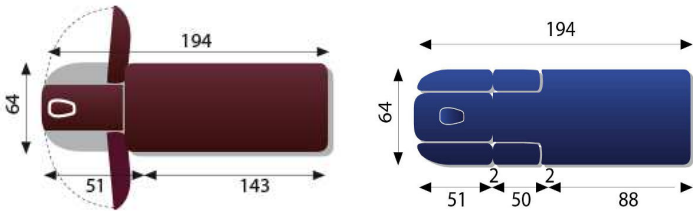

Höhe: **verstellbar 48 Δ 90 cm**

Rollendurchmesser: **60 mm**

Serie: FERROX STUDIO	**MODELL:** **“Matisse Pro II”** 	
MATISSE PRO II	**240011**	**241011**
MATISSE PRO II mit Fernbedienung	**240011P**	**241011P**
MATISSE PRO II mit Rollen	**240011R**	**241011R**
MATISSE PRO II mit Fernbedienung und Rollen	**240011PR**	**241011PR**
Leegewicht	**Kg.100**	
Sichere Arbeitslast	**Kg.160**	
Maximale Belastung durch Arbeit	**Kg.200**	
Motor	**Elektrisch**	
Spannung und Frequenz	**100-240 V - Frequenz 50/60 hz**	
Strom	**1,50 A**	
Einschaltzeit	**2 Min. aktiv, 18 Min. passiv**	
Kraft	**8000N für Höhenverstellung**	
Erwartete Lebensdauer: Der Zeitraum, über den das Gerät verwendet werden kann, wird auf 10 Jahre geschätzt.		

IV. BEDIENELEMENTE UND EINSTELLUNGEN

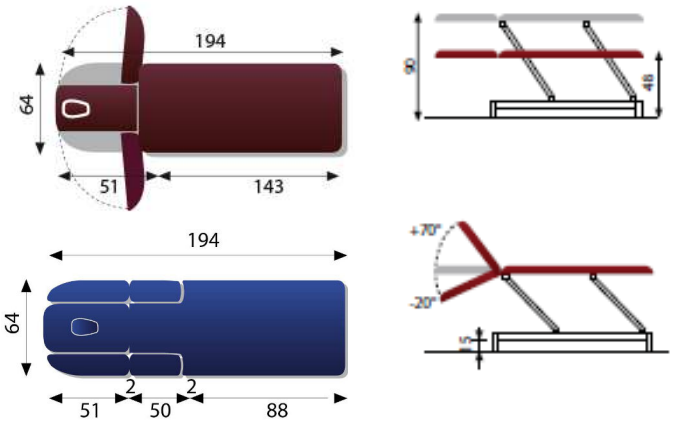

(1) - **240011, 240011R, 241011, 241011R**
HÖHENEINSTELLUNG **PER HANDSCHALTER**

(1A) - **240011P, 240011PR, 241011P, 241011PR**
HÖHENEINSTELLUNG
PER BEGRENZUNGS-FUSSSCHALTER

(2) HÖHENEINSTELLUNG DES KOPFTEILS DURCH **GASDRUCKFEDER**

A) <u>LIEGE MIT ELEKTRISCHER TASTENSTEUERUNG (FUNKTIONSSPERRE)</u>
STEUERUNG AKTIVIEREN:

- (I) Zum **Aktivieren**: Drücken Sie den Stift von links nach rechts,
- (O) Zum **Deaktivieren:** Ziehen Sie den Stift heraus
- Drücken Sie die „ON"-Taste, um die Handsteuerung zu aktivieren (grünes Licht leuchtet ☆)

⚠ **N.B. Die Handsteuerung muss bei jeder Benutzung neu aktiviert werden**
Die Handsteuerung schaltet sich nach 5 Sekunden Inaktivität automatisch ab

B) <u>LIEGE MIT FUSSPEDAL ODER MIT FERNBEDIENUNG</u>

Position **ON (I)** Stromkreis offen – Liege kann aktiviert werden.

Position **OFF** (**0**) Stromkreis geschlossen
Liege in Sicherheitsposition.

⚠ Der Bediener oder Benutzer sollte immer alle Funktionen ausschalten **(Off)** und den Magnet- oder mechanischen Sicherheitsschlüssel entfernen, bevor er die Therapieliege mit dem Patienten darauf unbeaufsichtigt lässt.
NACH JEDEM GEBRAUCH. Vergewissern Sie sich, dass alle Bedienelemente deaktiviert sind, wenn die Liege nicht in Gebrauch ist.

*** HÖHENEINSTELLUNG:**

1





240011, 240011R, *241011, 241011R*
MIT AKTIVIERTEM HANDSCHALTER
Drücken Sie die **(1),** bis die Liege ihre maximale Höhe oder die gewünschte Zwischenhöhe erreicht hat.
Drücken Sie die **(2),** bis die Liege ihre minimale Höhe oder die gewünschte Zwischenhöhe erreicht hat.

1A



240011P, 240011PR, *241011P, 241011PR*
BEDIENUNG
Rundumschaltung für alle Liegen
Bewegen Sie die Rundumschaltung mit Ihren Füßen nach links oder rechts um die Liege zu heben oder zu senken.

2



*** REGULIERUNG DER KOPFTEIL-NEIGUNG**

GASDRUCKFEDER

Um das Aus- und Einfahren der Gasdruckfeder zu steuern, ziehen Sie den unter dem jeweiligen Liegenteil positionierten Bedienungshebel. Heben oder senken Sie den entsprechenden Tischabschnitt, bis er die gewünschte Kippstellung erreicht hat. Lassen Sie den Hebel **langsam** los, um den Abschnitt in die gewünschte Kippstellung zu bringen. Abrupte Freigabe sperrt den Abschnitt sofort.

HINWEIS! VERWENDUNG VON GASDRUCKFEDERN BEI ALLEN FUNKTIONEN:

Achtung: Um Verletzungen von Arzt oder Patient vorzubeugen, halten und neigen Sie den betreffenden Liegenabschnitt mit einer Hand, **bevor** Sie den Hebel für die gasdruckfederunterstützte Neigungsverstellung betätigen, um zu verhindern, dass der Abschnitt in seine Ursprungsposition zurückschnellt.

***HÖHENVERSTELLUNG DER ARMLEHNEN**
Nutzen Sie die Handschraube an der Schiebehülse.

SCHLIEßEN



ÖFFNEN

Entriegeln: Drehen Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn
Lösen Sie die Armlehne indem Sie einen leichten Abwärtsdruck ausüben.

Drehen Sie die Handschraube im Uhrzeigersinn um die Armlehne in der gewünschten Position zu fixieren.
Armlehne zum Öffnen nach außen ziehen und zum Schließen in die entgegengesetzte Richtung drücken.
Führen Sie dieselben Schritte durch, um die Neigung der Armlehne zu verstellen.

RÄDER: Wenn vorhanden, drücken Sie den Steuerhebel nach unten, um die Räder abzusenken, bis sie sicher und fest auf dem Boden aufliegen. Die Räder dürfen nur zum Versetzen des Tisches verwendet werden.
Wenn die Räder nicht benötigt werden, müssen sie hochgestellt bleiben (keinen Bodenkontakt).

V. VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ERSATZTEILE – KUNDENDIENST

	Zum Anheben **T5EM001** ** ACTUATOR TA7 8000N IP66	**art. TA7-2300-001**	Seriennummerxxxx
	**T1EM001 ** ** Speisegerät TP8	**art. TP8-2300-001**	Seriennummerxxxx
	**T3EM002 ** ** Control box TC14	**art. TC14-4115-002**	Seriennummerxxxx
	T4EM009 ** FERNBEDIENUNG	**art. TH12-4115-004**	Seriennummerxxxx
	T4EM001 ** BEGRENZUNGS-FUSSSCHALTER	**art. TES-2300-001**	Seriennummerxxxx
	C3EM0181 ** FUNKTIONSVERRIEGELUNG		Seriennummerxxxx

Gasdruckfeder:

C3PI0230 ** GASDRUCKFEDER 500N	**art. 756625**	Seriennummer xxxx
C3PI0319 ** GASDRUCKFEDER STEUERUNGSKABEL	**art. T1186008**	Seriennummerxxxx
**C3PI0321 ** ** SICHERUNG UND HEBEL	**art. CMGTA002B**	Seriennummerxxxx

Rollen:

C3RU0982**

**Referenz für Ersatzteile

PRODUKT INFORMATION

KENNZEICHNUNGSETIKETT

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE

MDR 2017/745

CE

Hersteller:

FERROX s.r.l.
Via del Lavoro 9 - 31013 Codogné (TV) ITALIA
+39 0438 777099 – +39 0438 777091
C. F. - P. IVA - R. I. IT 03613220262
: **info@ferrox.it**

SRN:IT-MF-000011243

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Name	*Code*	*UDI-BASIC:*
Liege MATISSE PRO II Basisausführung	***240011***	**805347043MATISSEPRODR**
Liege MATISSE PRO II mit Rundumschaltung	***240011P***	**805347043MATISSEPRODR**
Liege MATISSE PRO II mit Rädern and Rundumschaltung	***240011PR***	**805347043MATISSEPRODR**
Liege MATISSE PRO II mit Räder	***240011R***	**805347043MATISSEPRODR**
Liege MATISSE PRO II+II Basisausführung	***241011***	**805347043MATISSEPRODR**
Liege MATISSE PRO II+II mit Rundumschaltung	***241011P***	**805347043MATISSEPRODR**
Liege MATISSE PRO II+II mit Rädern and Rundumschaltung	***241011PR***	**805347043MATISSEPRODR**
Liege MATISSE PRO II+II mit Räder	***241011R***	**805347043MATISSEPRODR**

Die Produkte müssen die allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen des Anhangs I sowie die Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017 erfüllen.

Das Unternehmen erklärt ferner, dass die in dieser Konformitätserklärung angegebenen Produkte:
- der Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung gefährlicher Stoffe) zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, einschließlich der Bestimmungen der von der Europäischen Kommission erlassenen Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 entsprechen.

Klassifiziert (Anhang VIII, MDR 2017/745):

Klasse I (Regel 1)

Verfahren zur Bewertung der Konformität:

Technische Unterlagen gemäß Anhang II und III.

Datum: 09/01/2023

Verantwortlicher
FERROX s.r.l.

Unterschrift:

Stabilimento e sede legale:
via del Lavoro Z.I.
31013 Codogné (TV) Italia
Tel. +39 0438 777099 - 778370
Fax +39 0438 777091
P.IVA: IT 03613220262

e-mail: info@ferrox.it
www.ferrox.it

Vertrieb durch:

SPORTEC
Physio & Fitness

www.sport-tec.de

Sport-Tec GmbH
Physio & Fitness
Lemberger Str. 255
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0) 6331 1480-0
Fax: +49 (0) 6331 1480-220
E-Mail: info@sport-tec.de
Web: www.sport-tec.de